

LAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification) بررسی کارایی روش در تشخیص سالمونلا

علی کرمی^{*}، ابویکر مرادی، رحیم سروری، زینب احمدی

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...[عج]

تاریخ پذیرش: 18/6/88

تاریخ دریافت: 1/7/87

چکیده

مقدمه: سالمونلاها از مهمترین باکتری‌های بیماری و عامل تیفوئید، باکتریمی، آنتروکولیت و سالمونلوز است که از عفونت‌های مشترک انسان و حیوانات می‌باشد. بیماریهای ناشی از این عامل یک محض بزرگ بهداشتی در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما می‌باشد. بنابراین تشخیص سریع، دقیق و به موقع آن برای جلوگیری از اپیدمی و عوارض مخرب این باکتری ضروری به نظر می‌رسد. برای تشخیص سالمونلا روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان به روش کشت، Immunoassay، و روش‌های مولکولی PCR، Real-time PCR نامد. تمام این روش‌ها به زمان طولانی، تعداد زیاد باکتری درمنونه اولیه، تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و به افراد متخصص در این زمینه نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش نوین تشخیص مولکولی LAMP با روش PCR در تشخیص عامل عفونی سالمونلا تیفی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق روش PCR با روش LAMP جهت تشخیص 7 سویه سالمونلای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ژنوم باکتری‌ها طبق روش استاندارد استخراج و با پرایمرهای اختصاصی در دستگاه PCR بر اساس برنامه چرخه حرارتی تشخیص داده شدند. و در مقایسه با آن مجموعه پرایمرهای اختصاصی به روش LAMP در یک دمای واحد در بلوك حرارتی ساخته شده در داخل کشور تکثیر و محصولات ایجاد شده در ژل الکتروفورز از طریق بررسی ایجاد کدورت به روش چشمی مورد تشخیص قرار گرفتند.

یافته‌های پژوهش: بررسی نتایج دو روش در تشخیص مولکولی سالمونلاها نشان داد که روش LAMP سریعتر، ارزان‌تر و اختصاصی‌تر است و به جای دستگاه گران قیمت PCR و برنامه چرخه حرارتی چند دمایی آن با استفاده از یک بلوك حرارتی بسیار ساده و ارزان ساخت داخل کشور و در یک دمای واحد 62 درجه سانتی گراد و همچنین با مشاهده کمتر حاصل از فرایند تکثیر ژن‌ها در روش جدید در مقایسه با روش الکتروفورز در بررسی محصولات PCR در زمان کوتاه‌تری به تشخیص اختصاصی این سالمونلاها پرداخت.

بحث و نتیجه گیری: این روش می‌تواند جهت تشخیص مولکولی سریع، دقیق و ارزان با کاربرد گسترده در آزمایشگاه‌های تشخیصی و بخصوص تشخیص عوامل عفونی در آزمایشگاه‌های مناطق محروم و همچنین آزمایشگاه‌های سیار مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: سالمونلا، تشخیص مولکولی، PCR، DNA، LAMP

*نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...[عج]

E-mail: Karami@bmsu.ac.ir

مقدمه

- مقاآم به حرارت تکثیر می یابد،(13). این روش دارای مزایای بسیاری است که به آن ها اشاره می نماییم:
- (1) LAMP قادر است DNA را با کارایی بالا تحت شرایط تک دمایی (Isothermal) تکثیر نماید و می توان تشخیص را با تعداد اندک DNA شروع نمود.
 - (2) محصولات واکنش مخلوطی از DNA های ساختار سنجاق سری با اندازه های متفاوت و ساختار گل کلم مانند با حلقه های متعدد می باشد که از انیلینگ بین توالی های معکوس تکراری از توالی هدف ایجاد می گردد، که حتی در زیر میکروسکوپ نوری به راحتی قابل مشاهده اند، و امکان تشخیص انتخابی را فراهم می نمایند.
 - (3) LAMP بسیار اختصاصی عمل می کند زیرا با 4 پرایمر قادر است که 6 ناحیه ژنی از توالی هدف را در آغاز واکنش و 4 ناحیه را در طی واکنش LAMP مورد شناسایی قرار دهد.
 - (4) روش LAMP ساده و انجام آن آسان است، و تنها نیاز به پرایمر، DNA پلی مراز و مخلوط واکنش دارد و نیازی به ترمومایکلر ندارد و واکنش در حمام آب گرم یا بلوک های حرارتی قابل انجام است.(13)
 - (5) به وسیله ترکیب با نسخه برداری معکوس LAMP قادر است توالی های RNA را با کارایی بالا تکثیر نماید.(13)
 - (6) امکان آشکارسازی نتیجه نهایی واکنش بر اساس کدر شدن محیط عمل واکنش است که با چشم یا دستگاه قابل مشاهده است.(14)
 - (7) نیاز به واسرست نمودن DNA اولیه و حتی نیاز به استخراج DNA اولیه از برخی نمونه های بیولوژیک (مانند محیط کشت مایع) نمی باشد.(15-17)
 - پر واضح است که LAMP نیز همانند سایر روش ها دارای محدودیت هایی در طراحی پیچیده پرایمر است که البته آشنایان با بیوانفورماتیک قادر به انجام آن هستند،(18).
 - در این تحقیق دو روش PCR و LAMP برای

سالمونلاها دسته بزرگی از باسیل های گرم منفی اند که اندازه آن ها به طول 1 تا 3 و عرض 0/8 تا 0/5 میکرون می باشد.(1-4) بیماری ناشی از سالمونلا دارای سه حالت اصلی شامل تب روده ای (تیفوئید)، باکتریمی و آنتروکوکیت می باشد و هر یک می تواند باعث بروز عوارض متعددی از قبیل به تب، سردرد، کندی ضربان قلب، استفرار، اسهال، ازدیاد حجم کبد و طحال، تورم کیسه صفراء، زخم و ضایعات مفصلی گردد.(5-7) از این رو تشخیص به موقع و درست این باکتری در مواد غذایی و افراد مشکوک به آلودگی ضروری به نظر می رسد. روش های تشخیصی فعلی شناسایی این باکتری شامل روش کشت و تایید بیوشیمیایی نیاز به سه تا چهار روز زمان دارند،(8) روش های ایمنولوژیک و مولکولی نیز استفاده می شود اما هنوز مشکلات بسیاری در رابطه با حساسیت و اختصاصی بودن این روش ها وجود دارد.(9)

روش PCR روشی سریع و حساس است که دارای مزایای بسیاری است اما دارای محدودیت هایی نیز می باشد مانند چرخه های حرارتی زیاد، استفاده از دستگاه ترمومایکلر گران قیمت و روش های آشکار سازی و تشخیص محصول و به همین دلیل امکان استفاده در آزمایشگاه های صحرایی و سیار را ندارد.(10-12)

روش جدید تکثیر هم دمای DNA وابسته به حلقه LAMP روشی ساده با کارایی بالا است که قادر این محدودیت هاست. این روش توسط نوتومی و همکاران در سال 2000 معرفی گردید، در این روش DNA به طور اختصاصی و با کارایی و سرعت بالا در شرایط تک دمایی (Isothermal) تکثیر می یابد.

در این روش از 4 پرایمر (دو پرایمر داخلی و دو پرایمر خارجی) استفاده می گردد، که در مجموع 6 ناحیه ژنی از DNA هدف را مورد شناسایی قرار می دهد و ناحیه هدف طی فرایندی دنباله دار و با تشکیل نواحی سنجاق سری در دمای 60-65 درجه سانتی گراد و با استفاده از یک آنزیم DNA پلی مراز

در این تحقیق ساخت داخل کشور می باشد. روش آماده سازی نمونه ها: از هر یک از نمونه های فوق به میزان 50 مایکرولیتر برداشته و در 1/5 سی سی محیط کشت مایع LB کشت داده شدند و به مدت 24 ساعت در گرم خانه 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند، و بعد از گذشت این زمان تمام آن ها رشد کردند و آماده استخراج ژنوم شدند. DNA سالمونلاهای کشت داده شده به روش استاندارد فنل کلروفرم (۱۹،۲۰) استخراج شده و سپس وجود ژنوم آن ها بر روی ژل آگاروز ۱ درصد تأیید گردید.

قبل از اقدام به انجام تست LAMP تأیید ژنوم سالمونلا از روش PCR متداول از پرایمرهای زیر و روش بهینه سازی شده PCR جهت تشخیص مولکولی سالمونلا که توسط کرمی و همکاران انجام شده بود استفاده گردید.(21-23)

تشخیص سالمونلا بررسی گردید و نشان داده شد که روش LAMP نسبت به PCR آسان تر، سریع تر و دقیق تر است.

مواد و روش ها

در این تحقیق از 7 سویه مختلف سالمونلا که اسامی آن ها ذیلاً بیان شده استفاده گردیده است که از آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت تهیه شده اند.

Salmonella typhi (1)

Salmonella paratyphi A (2)

Salmonella paratyphi B (3)

Salmonella paratyphi C (4)

Salmonella enteritidis (5)

Salmonella infantis (6)

Salmonella havani (7)

سایر مواد مورد نیاز از شرکت سیناژن تهیه گردید. بلوک حرارتی بسیار ساده استفاده شده

جدول 1. توالی پرایمرهای استفاده شده برای واکنش PCR

serial	primer	sequence	Size(bp)	Size of PCR product(bp)
۱	ST ^۳	۵'-CTTGCTATGGAAGACATAACGAACC-۳'	۲۵	۲۵۸
۲	ST ^۴	۵'-CGTCTCCCATCAAAAGCTCCATAGA-۳'	۲۴	
۳	ST ^{۱۲}	۵'- GTATTGTTGATTAATGAGATCCG-۳'	۲۳	۳۷۳
۴	ST ^{۱۳}	۵'- ATATTACGCACGGAAACACGTT-۳'	۲۲	

در آزمایش PCR برای تکثیر قطعات مورد نظر، مشخصات آزمایش و مقادیر مواد استفاده شده به شرح زیر است(جداول 2 و ۳):

جدول 2. پروفایل حرارتی مورد استفاده برای تست

Tempture	Time	Cycle
۹۴ c°	۱ min	1
۹۴ c°	۳۰ Sec	30
۵۷ c°	۱ min	30
۷۲ c°	۱ min	30
۷۲ c°	۰ min	1

جدول 3. مقدارهای مورد استفاده برای انجام تست PCR

material	Amount(μl)
primer Forward	۰,۵
primer Reverse	۰,۵
Buffer ۱۰X PCR	۲,۵
dNTPs	۰,۵
MgCl ₂	۰,۵
Taq	۰,۹
DNApolymerase	
DNA	۱
D ₂ W	۱۴
Total Volume	۲۰

ژن‌ومهای استخراج شده فوق الذکر به روش اپتی مایز شده فوق به وسیله شد که توالی آن‌ها مطابق جدول ۴ می‌باشد.

جدول 4. لیست توالی پرایمرهای استفاده شده در تست LAMP

primer	Type	Lenght	Sequence
FIP	Forward-inner (۵' - F' C, F' C-TTTT-F' - ۳')	۴' nt(F' C, F' C-TTTT-F' - ۳') ۲' nt; F', ۲' nt)	۵'-GACGGCTGGTACTGATCGATAGTTTTAACGTTCTGCAG - ۳'
BIP	Backward-inner (۵' - B' C, B' C-AAAA-B' - ۳')	۴' nt(B' C, B' C-AAAA-B' - ۳') ۲' nt; B', ۲' nt)	۵'-CCGGTGAAATTATGCCACACAAAACCCACCGCCAGG - ۳'
F ³	Forward outer	۲' nt	۵'-GGCGATATTGGTGTATGGGG - ۳'
B ³	Backward outer	۲' nt	۵'-AACGATAAACTGGACCACGG - ۳'

فاکتورهای مؤثر میزان مواد وسیکل حرارتی در واکنش LAMP به شرح زیر می‌باشند(جدول ۵ و ۶):

تمام فاکتورهای مؤثر در واکنش LAMP بهینه‌سازی شد تا تکثیر قطعه مورد نظر به خوبی انجام شود. بعد از اعمال تمام

جدول 5. میزان مواد استفاده شده در تست LAMP

material	Amount(μl)	concenteration
D ₂ W	۱۱,۵	-
Buffer ۱۰X	۲,۵	۰,۲ mM
Betain	۲	۰,۴ mM
dNTPs	۰,۵	۰,۲ mM
Bst	۰,۵	۸ Unit
DNApolymerase		
Primer FIP	۲	۰,۹ pm
Primer BIP	۲	۰,۹ pm
Primer F ³	۰,۵	۰,۲ pm
Primer B ³	۰,۵	۰,۲ pm
DNA	۳	-
Volume	۲۵	

جدول ۶. سیکل حرارتی جهت انجام تست LAMP

Temperture	Time	cycle
۶۵°C	۴۵ min	۱
۸۲°C	۱۰ min	۲


کسب بهترین نتیجه عوامل مختلف موثر در فرایند تکثیر مانند میزان مواد مختلف و شرایط حرارتی بهینه سازی های مختلفی صورت گرفت.

نمونه ژنوم استخراج شده سالمونلا را بر طبق روش بهینه سازی شده LAMP تکثیر شدند. سپس محصول روی ژل آکارز 2 درصد الکتروفورز بررسی شد. برای

یافته های پژوهش

ژنوم سالمونلاهای مختلف بررسی شده آزمایش LAMP صورت گرفت.

بعد از انجام تست PCR و تأیید قطعات مورد انتظار از

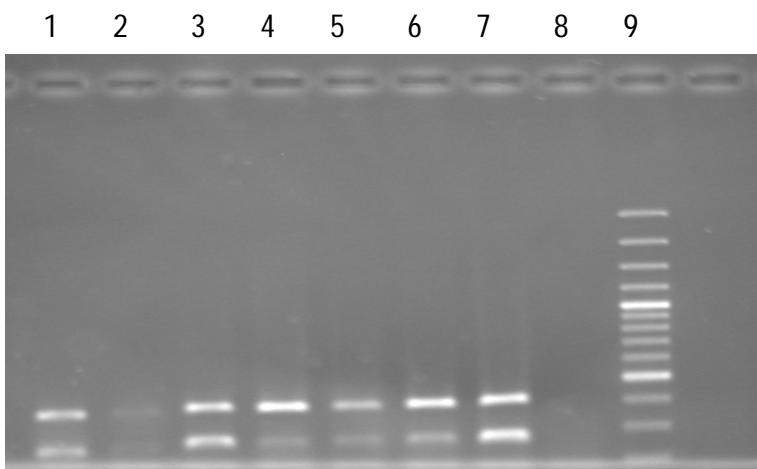

شکل ۱. الکتروفورز نمونه های تست PCR جهت تایید ژنوم سالمونلا

۱- سالمونلاتیوفی ۲- سالمونلا ایتریدیس ۳- سالمونلا پاراتیوفی A ۴- سالمونلا تیوفی B ۵- سالمونلا تیوفی C ۶- سالمونلا havani ۷- سالمونلا Infantic ۸- کنترل منفی ۹- وزن مولکولی (500 bp- 400 bp- 300 bp- 200bp- 100bp)

واکنش LAMP شامل 30، 45، و 60 دقیقه که در زمان 30 دقیقه هیچ محصولی تولید نشد. در 45 دقیقه محصول اندکی تولید شد و در 60 دقیقه میزان محصولات به حداقل رسید،


بنابراین مشخص گردید که واکنش LAMP را در 65 درجه سانتی گراد به مدت 60 دقیقه اپتی بهترین نتیجه را می دهد ولی تجربه نشان داد که در صورت ادامه واکنش به مدت 10 دقیقه در 82 درجه سانتی گراد. نتایج بهتر خواهد بود و این نتایج با تحقیق Li et al. (۲۰۰۵) و Maeda et al. (۲۰۰۷) مطابقت دارد. با به کارگیری هر یک

آزمایش LAMP صورت گرفت همچنان که در شکل 2 دیده می شود در الکتروفورز باندهای متعدد نردهایی شکلی که اندازه آن ها از 241bp به بالا می باشد مشاهده می شوند که از مشخصات بارز این روش است و انجام واکنش اختصاصی از این طریق مشخص می شود. در کنترل منفی که فاقد DNA الگو است هیچ باندی قابل روئیت نیست.

انجام بهینه سازی ها مشخص نمود که بهترین نتیجه در دمای 65 درجه سانتی گراد است زیرا در این دما میزان تکثیر DNA افزایش می یابد، بهینه سازی زمان واکنش مشخص نمود که از زمان های مختلف

نشد، بنابراین برای انجام واکنش وجود هر دو جفت پرایمر الزامی است.

از پرایمرهای (FIP,BIP,F³&B³) به طور مجزا یا جفت و حتی استفاده از 3 پرایمر هیچ محصولی تولید نمی‌کند.

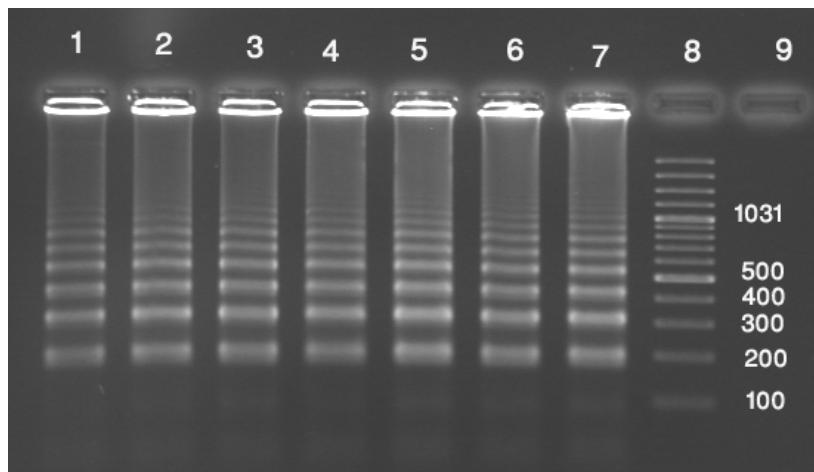

شکل ۳. الکتروفورز نمونه‌ها تست LAM جهت تایید ژنوم سالمونلا

۱- ژنوم باکتری سالمونلاتیفی ۲- ژنوم باکتری سالمونلا ینتربینتیس ۳- ژنوم باکتری سالمونلا پاراتیفی A ۴- ژنوم باکتری سالمونلا تیفی C ۵- ژنوم باکتری سالمونلا havani ۶- ژنوم باکتری سالمونلا Infantic ۷- ژنوم باکتری سالمونلا ۸- وزن مولکولی (پرنگ ترند) ۹- کنترل منفی

spvC و floc و spvC طراحی و بررسی نموده اند.(25). بررسی روش‌های PCR فوق سریع موسوم به روش Real-time در تشخیص سریع سالمونلا نشان داده است که این روش‌ها کارایی مناسبی داشته و لیکن دستگاه استفاده شده بسیار گران قیمت است. در روش LAMP برای تشخیص سریع سالمونلا از دو جفت پرایمر طراحی شده بر اساس ژن invA که قادر به شناسایی انواع سالمونلا می‌باشد استفاده شده است و تشخیص بسیار سریع و دقیق انجام می‌گیرد.(22,24). این روش دارای مزایای بسیاری است و قادر است DNA را با کارایی بالا تحت شرایط تک دمایی(Isothermal) تکثیر نماید و تشخیص را می‌توان با تعداد اندک DNA شروع نمود. LAMP حتی قادر است DNA را در کمتر از 6 کپی در مخلوط واکنش شناسایی نماید، بسیار اختصاصی عمل می‌کند زیرا با 4 پرایمر قادر است که 6 ناحیه ژنی از توالی هدف را در آغاز واکنش و 4 ناحیه را در خلال واکنش اصلی LAMP مورد شناسایی قرار دهد. انجام آن آسان است، و تنها نیاز به پرایمر، DNA پلیمراز و مخلوط واکنش دارد و نیازی به ترموسایکلر ندارد و واکنش در حمام آب گرم یا بلوك‌های حرارتی

در مقایسه PCR (شکل ۱ و ۳) در LAMP تنها ژن invA در از اندازه‌های متفاوت از 241bp به بالا تکثیر می‌یابد ولی در PCR برای هر جفت پرایمر تنها یک باند مشاهده می‌گردد. برای پرایمرهای S³ و S⁴ 258bp و پرایمرهای S1² و S1³ 373bp مشاهده می‌شود. در invA پرایمرهای طراحی شده تنها قادر به تکثیر ژن invA هستند و با این پرایمرها تنها قادر به تشخیص سالمونلا LAMP می‌باشیم. از نظر حساسیت در تشخیص LAMP نسبت به PCR برابر حساستر است. (25)

بحث و نتیجه‌گیری

روش‌های متداول تشخیص سالمونلا نیازمند زمان طولانی است که فاقد کارایی لازم جهت تشخیص سریع این باکتری می‌باشد.(19). از روش PCR معمولی جهت تشخیص، شناسایی و تفکیک سالمونلا از سایر انتروباکتریا سه ها استفاده شده است.

روش LAMP روش تشخیصی سریع تر و مقرون به صرفه تری است.(12). محققین جهت تشخیص مولکولی سالمونلا تیفی پرایمرهای مختلفی را بر اساس رده‌ی ژن‌های شناخته شده، int-, prt, tyv, fiC-dT, fiC-a, invB, invA

مهم مسؤول تهاجم باکتری به سلول های اپیتلیال است. در این تحقیق با بهینه سازی های انجام شده در طی واکنش LAMP زمان نهایی تشخیص نسبت به PCR بسیار کوتاه گردید، جهت انجام این کار فاکتورهای مؤثر در واکنش از قبیل آنزیم، dNTP، پرایمرها، بتائین، DNA الگو و زمان انجام واکنش بهینه سازی بتائین، DNA الگو و زمان انجام واکنش بهینه سازی شدند که نسبت به تلاش هایی که جهت کوتاه نمودن زمان تشخیص باکتری های بیماری زا از جمله سالمونلا که با دستگاه های متداول PCR صورت گرفته است قابل توجه می باشد.

قابل انجام است امکان آشکارسازی نتیجه نهایی واکنش بر اساس کدر شدن محیط عمل واکنش که به واسطه آزاد شدن پیرو فسفات از dNTP ها و ترکیب آن ها با یون های منیزیم در حین واکنش ایجاد می گردد، و امکان آنالیز نتایج را آسان می نماید که این مورد در بین تمام روش های مولکولی تکثیر DNA بی نظیر است.

مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه نشان داد که استفاده از پرایمرهایی که بر اساس ژن invA (invA invasion protein) هستند کارایی بالایی در تشخیص سالمونلا به روش LAMP دارند، زیرا این ژن از ژن های

References

- ۱-Zahraei-sallehi T. Salmonella. Tehran University Publication ۱۹۸۶. p. ۸۶. (Persian)
- ۲-Collier L, Balows A, Sussman M. Topley and Wilson's microbiology and microbial infections. ۹th ed. London, Edward Arnold, ۱۹۹۸. Vol. ۲. p. ۱۹۶۹-۹۷.
- ۳-Soltani MJ, Shahhosseiny MH, Shahbazzadeh D. Selective amplification of prt, tyv and inv A genes by multiplex PCR for rapid detection of salmonella typhi. J Iranian Biomedical ۲۰۰۰; ۹: ۱۳۵-۸.
- ۴-Guthrie KR. Salmonella .Bocan Rotan Ann Arbor London ۱۹۹۱. ۲۳-۴۰.
- ۵-Abhyankar A. Salmonellosis and its laboratory diagnosis[online].(cited ۲۰۰۴). Available from: URL:<http://bacteriology.Htrn. www.Geoties.Com/> avinash abhyankar
- ۶-Watson PM, Paulin AP. Characterization of intestinal invasion by salmonella typhimurium and salmonella dublin and effect of a mutation in the invH gene. Infect Immun ۱۹۹۰; ۶۳: ۲۷۴۳-۵۴.
- ۷-Bell c, Kyriakides A. Salmonella, a practical approach to the organism and its control in food. Blackwell Science. ۲۰۰۰.p. ۱-۲۰.
- ۸-Moore P. Replicating success. J Nature ۲۰۰۰; ۴۳۵: ۲۳۰-۸.
- ۹-Hoorfar P, Radstro M. Automated nuclease PCR assay for identification of Salmonella enterica. J Cli Microbiology ۲۰۰۰; ۳۴۲۹-۳۵.
- ۱۰-Morel G, Raccurt M. PCR in situ light and electron I microscopy ۲۰۰۵; ۵,.I.E. Manual of standards for diagnosis tests and vaccines ۱۹۹۲.p.۴۰۸-۲۰.
- ۱۱-Figueroa-Bossi N, Bossi L. Inducible prophages contribute to salmonella virulence in mice.J Mol Microbiogy ۱۹۹۹; ۳۳: ۱۶۷-۷۶.
- ۱۲-Ashwani K, Vineet Aa, Anu B, Sher A. Detection of Salmonella typhi by polymerase chain reaction: implications in diagnosis of typhoid fever Infection. J Genetics and Evolution ۲۰۰۲; ۲: ۱۰۷-۱۰.
- ۱۳-Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, Yonekawa T. Loop-mediated isothermal amplification of DNA. J Nuc Acids Res ۲۰۰۰; ۲۸: ۶۳.
- ۱۴-Mori Y, Magamine K, Tomita N, Notomi T. Detection of loop-mediated isothermal amplification by turbidity derived from magnesium pyrophosphate formation. Biochem Biophys Res Commun ۲۰۰۱; ۲۸۹: ۱۵۰-۴.
- ۱۵-Kaneko H, Kawana T, Fukushima E, Suzutani T. Tolerance of loop-mediated isothermal amplification to a culture medium and biological substances. J Biochem Biophys Methods ۲۰۰۷; ۷۰: ۴۹۹-۵۰۱.
- ۱۶-Nagamine K, Watanabe K, Ohtsuka K, Notomi T. Loop-mediated isothermal amplification reaction using a nondenatured template. J Clin Chem ۲۰۰۱; ۴۷: ۱۷۴۲-۳.
- ۱۷-Mori Y, Hirano T, Notomi T. Sequence specific visual detection of LAMP reactions

- by addition of cationic polymers. *J BMC Biotechnol* ۲۰۰۷; ۶: ۱-۱۰.
- ۱۸-Demidov VV. A new use for old stuff: DNA hairpins in DNA amplification. *J TRENDS in Biotechnol*, ۲۰۰۲; ۲۰: ۱۸۹-۹۰.
- ۱۹-Kochl S, Niedersttter H, Parson W. DNA extraction and qntitation of forensic samples using the phenol-chloroform method and real-time PCR. *J Methods Mol Biol* ۲۰۰۵; ۲۹۷: ۱۳-۳۰.
- ۲۰-Boom R, Sol CJ, Salimans MM, Jansen CL, Wertheim van, Dillen PM. Rapid and simple method for purification of nucleic acids. *J Clin Microbiol* ۱۹۹۰; ۲۸: ۶۹۰-۶۹۳.
- ۲۱-Karami A, Ahmadi Z, Safiri Z. [Rapid detection of typhoid agent with multiplex PCR bases of *tyv,invA,prt* genes and comparing of isolated sequence from Iran with gene bank sequence]. *J Kaosar Med* ۲۰۰۶; ۱۱: ۱-۱۲. (Persian)
- ۲۲-Karami A, Ranjbar R, Ahmad Z, Safari Z. [Rapid detection of different serovars of *Salmonell* antrica by multiplex PCR]. *Iranian J Pub Health* ۲۰۰۷; ۳۶: ۳۸-۴۲. (persian)
- ۲۳-Karami A, Morrovati S, Ahmadi Z, safari Z, khalilpour A. [Development of an ultra rapid and simple multiplex polymerase chain reaction technique for detection of *salmpnella typhi*]. *Sci Med J* ۲۰۰۶; ۲۷: ۱۱۳-۴-۸. (persian)
- ۲۴-Maeda H, Kokeguchi S, Fujimoto C, Tanimoto. Detection of periodontal pathogen *Porphyromonas gingivalis* by loop-mediated isothermal amplification method. *FEMS Immuno and Med Microbiology* ۲۰۰۵; ۴۳: ۲۲۳-۹.
- ۲۵-Wang Li, Lei Shi, Alam MJ, Geng y, Lin Li. Specific and rapid detection of foodborne *Salmonella* by loop-mediated isothermal amplification method. *Food Research International* ۲۰۰۷; 10: ۱۰۱۷.



Evaluation of LAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification) for Molecular Detection of *Salmonella*

Karami A*, Moradi A, Sorouri R, Ahmadi Z

(Received: 22 Sep, 2008)

Accepted: 7 Sep, 2009)

Abstract

Introduction: *Salmonella* Bacterium is not only a causative factor of typhoid fever, enterocolitis, and salmonellosis, but it is also a zoonotic infection. This bacterium is a major health problem throughout the world, and is especially prevalent in developing countries. Therefore, rapid diagnosis of salmonella can prevent its outbreak. Different techniques are used for the diagnosis of *Salmonella* bacteria, such as; culture, biochemical, serological, ELISA, Widal, immunofluorescence and molecular methods like PCR and Real time PCR, all of which are difficult, time-consuming, and expensive. Thus, our study was designed to evaluate the LAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification method) for detection of salmonella bacteria.

Materials & Methods: In this study, we examined 7 different strains of salmonella. The DNA was extracted by standard methods and amplified with specific primers by PCR and set of primers for LAMP in single temperature in very simple thermal block made in Iran. The amplified products were detected by gel electrophoresis and LAMP products were visualized by their turbidity with naked eye.

Findings: Conventional PCR method for detection of *Salmonella* needs standard thermocycler and takes 3 hours, but using LAMP method, we were able to amplify and detect salmonella in simple thermoblock, taking much less time. After optimization of the process, it was, soon, possible to detect and identify *Salmonella typhi* bacteria within 90 minutes. This method is also 10 times more sensitive than that of the PCR.

Discussion & Conclusion: According to the results, comparing LAMP method for detection and identification of *Salmonella* with conventional PCR, we have been able to determine the simplicity, speed and the superior sensitivity of the LAMP method. This Method is more simple, faster and cheaper. Non-dependence of cycle's temperature and thermo-cycling and replacement with one thermo block which is very simple, inexpensive and made inside the country, can be considered another advantage of the LAMP method.

Key Words: *Salmonella*, molecular detection, PCR, DN, LAMP

Research Center of Molecular Biology, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
*(corresponding author)